


精明選購 及正確使用 男性安全套




醫療器械科
Medical Device Division
www.mdd.gov.hk

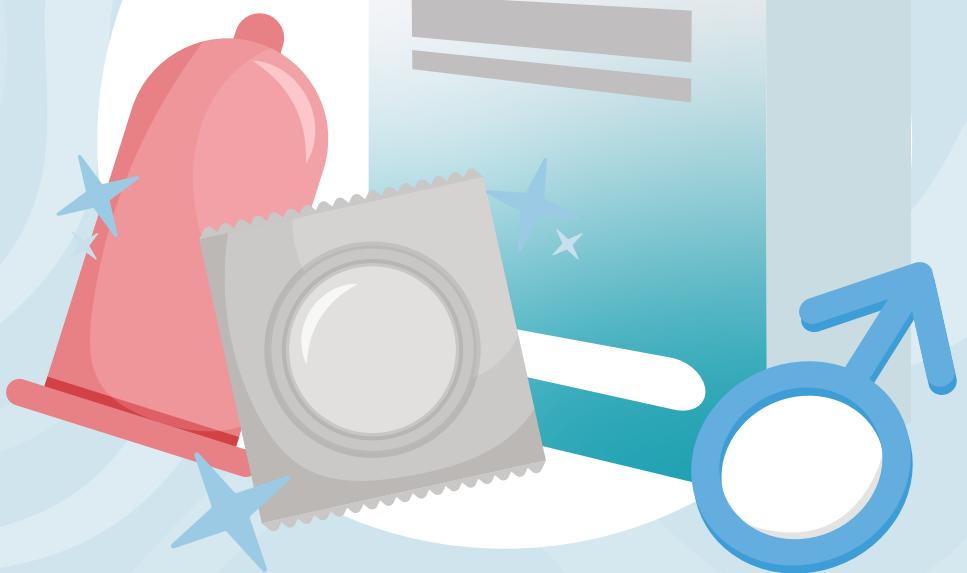

衛生署
Department of Health


安全套

在「醫療器械行政管理制度」下，安全套通常屬於第III級中高風險的一般醫療器械。但含有藥劑製品（例如：麻醉藥）的安全套，則屬於第IV級高風險一般醫療器械



每次性行為都要正確地使用安全套

- 透過物理屏障的方式防止精子進入女性的生殖器官來避孕
- 預防性傳播感染，例如愛滋病、梅毒、淋病（俗稱白濁）、非淋病性尿道炎（男性）/ 非特異性生殖道感染（女性）、性病疣（俗稱椰菜花）、陰部疱疹與陰蟲等



性傳播感染


性傳播感染是透過性行為傳播，例如陰道性交、口交和肛交等

患有性傳播感染不但會增加感染愛滋病病毒的風險，也可能導致其他嚴重的健康後果，例如不育，甚至死亡。另外，感染者亦可能會透過母嬰傳染影響新生嬰兒，例如先天性缺陷

正確地使用安全套可有效地降低性傳播感染風險和避孕



正確使用安全套

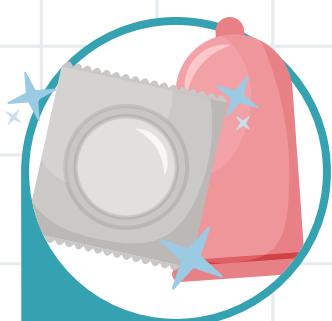

- 每次性行為時，
使用一個新的安全套




- 如有需要，可使用水溶性潤滑劑。
油性潤滑劑可能會導致安全套破裂，降低安全套效能



正確使用安全套

有效期限：XX-XX-XXXX

!

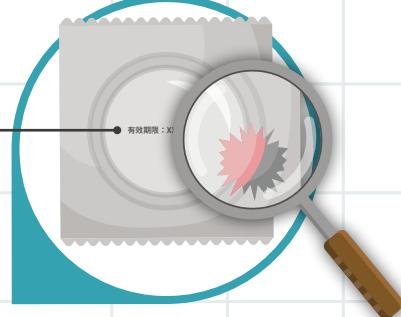

使用前要檢查**有效期限**和**包裝的完整性**，以確保安全套的效能



細閱及遵從使用說明，包括用後處理方法。用完的安全套應用紙巾包裹好，棄置於垃圾箱內



如對正確使用安全套有疑問，請諮詢醫護專業人員



精明選購安全套



選購已於「**醫療器械行政管理制度**」表列，並附有**表列號碼**的安全套，以確保安全套能符合表列制度下**安全、品質及性能**的要求

* 你可以在醫療器械科網站上的醫療器械列表搜尋已表列器械的資料



更多資訊關於已表列的安全套，
請參閱醫療器械科相關專題網頁

安全套的專題網頁

<https://www.mdd.gov.hk/tc/information-publication/thematic-pages/index.html>



- 表列號碼
(HKMD No.)
- 製造商
- 品牌及型號
- 本地負責人
- 包裝



醫療器械科